REF EXTV

GABILINK - EXTENSOR VALVULADO GMI

APRESENTAÇÃO

São apresentados nas seguintes dimensões e códigos:

GABILINK - EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI					
Código	**Comp. do extensor (cm)**	**Nº válvulas**	**Vol. interno (ml)**	**Uso**	**Fluxo* (ml/min)**
EXTV10-2	10,0	2	0,60	Neonatal	≅200
EXTV15	15,2	2	1,00	Pediátrico	≅200
EXTV16-2	16,5	2	1,45	Adulto	≅200
EXTV16-4	16,5	4	2,27	Adulto	≅200
≅ Aproximadamente					
VASNT – Válvula ativa *safety* neutra					
Código	**Comp. (cm)**	**Diâmetro (mm)**	**(PSI)**	**Vol. Morto (ml)**	
VASNT	3,0	11	350	0,04	

***Fluxo gravitacional**

ESQUEMA DO PRODUTO

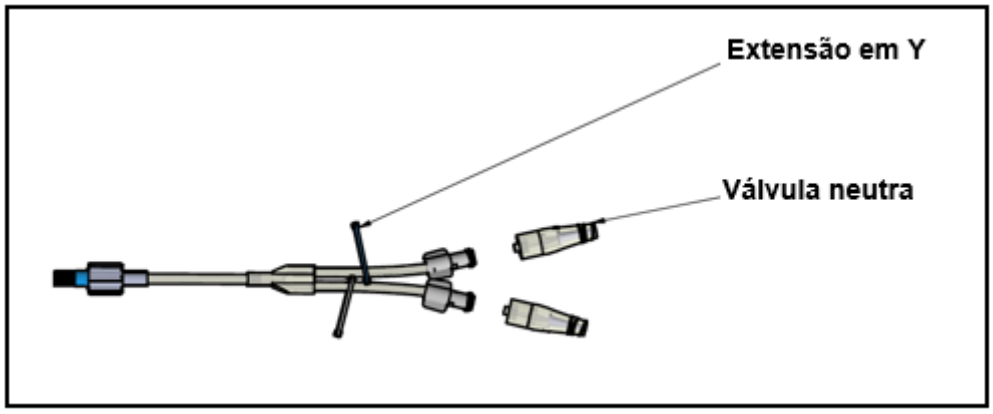

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

Projetado para infusão de soluções, drogas, sangue e Lipídeos.

COMPOSIÇÃO

Características do extensor: É composto de tubo de PVC sem DEHP, pinças deslizantes corta fluxo, adaptador luer lock macho contendo tampa protetora com filtro, adaptador luer fêmea com válvula luer ativa e conector luer.

Características da válvula: Corpo e cânula interna em policarbonato resistente para passagem da solução, anel de silicone flexível para vedação da cânula interna, capacidade de até 200 ativações.

INSTRUÇÕES DE USO

- Verifique se os clamps estão abertos;
- Conecte uma seringa a válvula e realize o preenchimento do dispositivo com solução fisiológica ou água destilada;
- Observe se houve preenchimento total do dispositivo;

- Acesse a válvula do dispositivo de conexão diretamente contra a superfície do luer ativado e girar até que conexão esteja segura;
- Realize a assepsia da válvula com o antisséptico de preferência antes do uso e antes de cada conexão subsequente;
- O período de utilização deve seguir conforme protocolo Institucional,

ADVERTÊNCIAS

- Garantir que todas as conexões luer em linha estão seguras antes do uso.
- Não deixar ar dentro do dispositivo.
- Para minimizar o refluxo durante a limpeza, manter a pressão positiva no êmbolo da seringa enquanto pinça o extensor de equipo.
- Substituir a válvula se apresentar instabilidade na utilização.
- Não acessar a válvula com agulhas. A tentativa deste acesso causará danos no produto, substituir imediatamente.
- É recomendado o uso de conexão luer lock. Se a conexão luer slip for utilizada, insira o dispositivo empurrando firmemente em movimento rotatório.
- Realizar a lavagem do dispositivo com solução salina após infusão/coleta de sangue, caso não seja possível substituir a válvula.
- Traçar linhas antes da conexão. Não conectar nenhum dispositivo de gás comprimido nos sítios de injeção intravenoso.
- Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, rasgos ou danos na superfície externa do produto.
- Este produto não contém látex de borracha natural, e componentes metálicos.

RECOMENDAÇÕES

- O produto é fabricado utilizando materiais resistentes a lipídeos e pode ser utilizado para administrar soluções de base lipídica.
- Para evitar que o fluxo retroceda, não permitir que as múltiplas fontes de fluido permaneçam conectadas ao extensor sem ajustar a pinça deslizante.
- Lavar a válvula após injeção para prevenir mistura inadvertida de medicações, fluidos incompatíveis, infusão ou coleta de sangue.
- Armazenar a temperatura ambiente, evitar calor excessivo.

STERILE EO — Esterilizado por óxido de etileno

Proibido Reprocessar

EMBALAGEM

Envelope individual pouch, com papel apto a esterilização por ETO.

DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica.

EFEITOS COLATERAIS

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

Resp. Técnica - Dra. Josimara dos Santos Almeida Possidonio - CRF-SP 54.659
REG ANVISA: 80423549005

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Detentor do Registro: CNPJ 08.633.431/0001-05
Fabricado por: CNPJ 08.633.431/0003-69
Av: Victor Andrew, 521, Bairro: Zona Industrial
CEP 18086-390 Sorocaba – SP Tel/fax:15 3238-4100