REF SEVS

INSTRUÇÃO DE USO

GABILINK AIR - EXTENSOR VALVULADO *SAFETY* GMI

APRESENTAÇÕES

São apresentados nas seguintes dimensões e códigos:

GABILINK AIR - EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI					
Código	**Comp. do extensor (cm)**	**Nº válvulas**	**Vol. *Priming* (ml)**	**Uso**	**Fluxo* (ml/min)**
SEVS10-2	10,0	2	0,60	Neonatal	≅200
SEVS15	15,2	2	1,00	Pediátrico	≅200
SEVS16-2	16,5	2	1,45	Adulto	≅200
SEVS16-4	16,5	4	2,27	Adulto	≅200
ACESSÓRIO: Conector Luer com filtro 1,2 mícron (SF) ≅ Aproximadamente *Fluxo gravitacional					
VASNT – VÁLVULA ATIVA SAFETY NEUTRA					
Código	**Comp. (cm)**	**Diâmetro (mm)**	**(PSI)**	**Vol. Morto (ml)**	
VASNT	3,0	11	350	≅0,04	

ESQUEMA DO PRODUTO

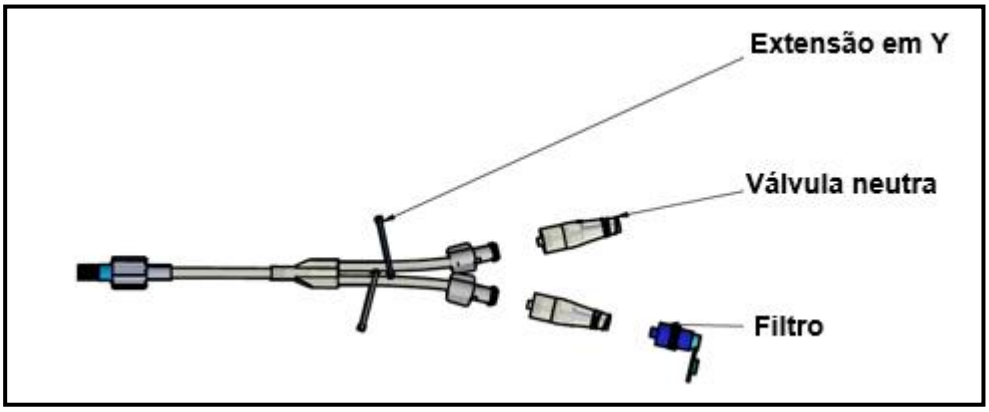

FINALIDADE E INDICAÇÕES

Projetado para infusão de soluções, drogas, sangue e Lipídeos.

COMPOSIÇÃO

Características do extensor: É composto de tubo de PVC sem DEHP, pinças deslizantes corta fluxo cores distintas para diferenciação das vias, adaptador luer lock macho contendo tampa protetora com filtro, adaptador luer fêmea com válvula luer ativa e conector luer com Filtro 1,2 mícron.
Características da válvula: Corpo e cânula interna em policarbonato resistente para passagem da solução, anel de silicone flexível para vedação da cânula interna, capacidade de até 200 ativações.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

- Verifique se os clamps estão abertos;
- Conecte uma seringa a válvula que não possui filtro e realize o preenchimento do dispositivo com solução fisiológica ou água destilada;
- Observe se houve preenchimento total do dispositivo;
- Retire e despreze o filtro da válvula para correto funcionamento do dispositivo;
- Acesse a válvula do dispositivo de conexão diretamente contra a superfície do luer ativado e girar até que conexão esteja segura;
- Realize a assepsia da válvula com o antisséptico de preferência antes do uso e antes de cada conexão subsequente;
- O período de utilização deve seguir conforme protocolo Institucional.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Garantir que todas as conexões luer em linha estão seguras antes do uso.
- Não deixar ar dentro do dispositivo.
- Para minimizar o refluxo durante a limpeza, manter a pressão positiva no êmbolo da seringa enquanto pinça o extensor de equipo.
- Substituir a válvula se apresentar instabilidade na utilização.
- Não acessar a válvula com agulhas. A tentativa deste acesso causará danos no produto, substituir imediatamente.
- É recomendado o uso de conexão luer lock. Se a conexão luer slip for utilizada, insira o dispositivo empurrando firmemente em movimento rotatório.
- Realizar a lavagem do dispositivo com solução salina após infusão/coleta de sangue, caso não seja possível substituir a válvula.
- Traçar linhas antes da conexão. Não conectar nenhum dispositivo de gás comprimido nos sítios de injeção intravenoso.
- Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, rasgos ou danos na superfície externa do produto.
- Este produto não contém látex de borracha natural, e componentes metálicos.

RECOMENDAÇÕES

- O produto é fabricado utilizando materiais resistentes a lipídeos e pode ser utilizado para administrar soluções de base lipídica.
- Para evitar que o fluxo retroceda, não permitir que as múltiplas fontes de fluido permaneçam conectadas ao extensor sem ajustar a pinça deslizante.
- Lavar a válvula após injeção para prevenir mistura inadvertida de medicações, fluidos incompatíveis, infusão ou coleta de sangue.
- Armazenar a temperatura ambiente, evitar calor excessivo.

EFEITOS ADVERSOS

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

REF SEVS

EMBALAGEM

Papel + filme plástico grau cirúrgico, apto a esterilização por ETO.

Biodegradável em Ambiente Anaeróbico

(Testado conforme ASTM D5511)

Nota: Aplica-se exclusivamente aos lotes com final "B"

DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica.

PROIBIDO REPROCESSAR

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO STERILE EO

ACESSE O QR CODE PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

SAC - *qualidade@gmimedicall.com*

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Detentor do Registro: CNPJ 08.633.431/0001-05
Fabricado por: CNPJ 08.633.431/0003-69
Av: Victor Andrew, 521, Bairro: Zona Industrial
CEP 18086-390 Sorocaba – SP
Tel/fax:15 3238-4100

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REG ANVISA: 80423540019

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

/gabisamedical